

Zusammenfassung / summary

Validierung / validation:

Alle Kontrollen und Validierungen lagen innerhalb der grundlegenden Grenzwerte. / *All controls and validations were within the basic limits.*

Abweichungen / deviations:

Beobachtete Abweichungen der geltenden Norm und Verfahren / *observed deviations from applicable standard and procedure:*

keine / *none*

Unwirksame Konzentrationen / ineffective concentrations:

50%, 10% = 1min
10% = 5min

Schlussfolgerung / conclusion:

Nach EN 16777 (2018) konnte mit der Charge B23006 des 2-Komponenten-Desinfektionsmittel **Sporosan® WD 42**, bestehend aus Sporosan® WD 42 H und Sporosan® WD 42 N, unter niedriger Belastung bei Raumtemperatur nach 1 und 5 Minuten unverdünnt (gemäß Herstellungsvorschrift der Anwendungslösungen) und nach 5 Minuten bei Verdünnung auf 50% (v/v) die erforderliche Titerreduktion von $\geq 4\lg$ Stufen von Murinem Norovirus nachgewiesen werden.

*According to EN 16777 (2018) the required $\geq 4\lg$ unit titre reduction of Murine Norovirus could be achieved with the batch B23006 of the 2-components-disinfectant **Sporosan® WD 42**, consisting of Sporosan® WD 42 H and Sporosan® WD 42 N, under clean conditions at room temperature in 1 and 5 minutes when used undiluted (according to the preparation instruction of the application solutions) and in 5 minutes when diluted at 50% (v/v).*

Zusammenfassung / summary

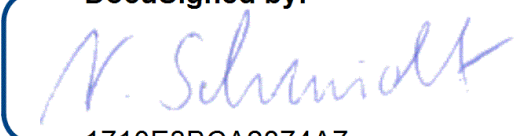
Archivierung / archiving:

Eine Ausfertigung des Berichtes wird zusammen mit den Rohdaten im Archiv des Auftragnehmers aufbewahrt. / A copy of the test report will be kept together with the raw data in the contractor's archive.

Hinweis / note:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfprodukte. Auszugsweise Wiedergabe dieses Berichtes nur mit schriftlicher Genehmigung der HygCen Germany GmbH. / The test results refer only to the named test samples. Reproduction of any part of this report requires the written permission of HygCen Germany GmbH.

Schwerin, 2025-04-04

DocuSigned by:

1710E3BCA2874A7...

Dipl. Ing. (FH) N. Schmidt
Division Manager
Virological Test Methods